


Synicem


MAXILARIA

Vertebroplastía
Vertebroplasty

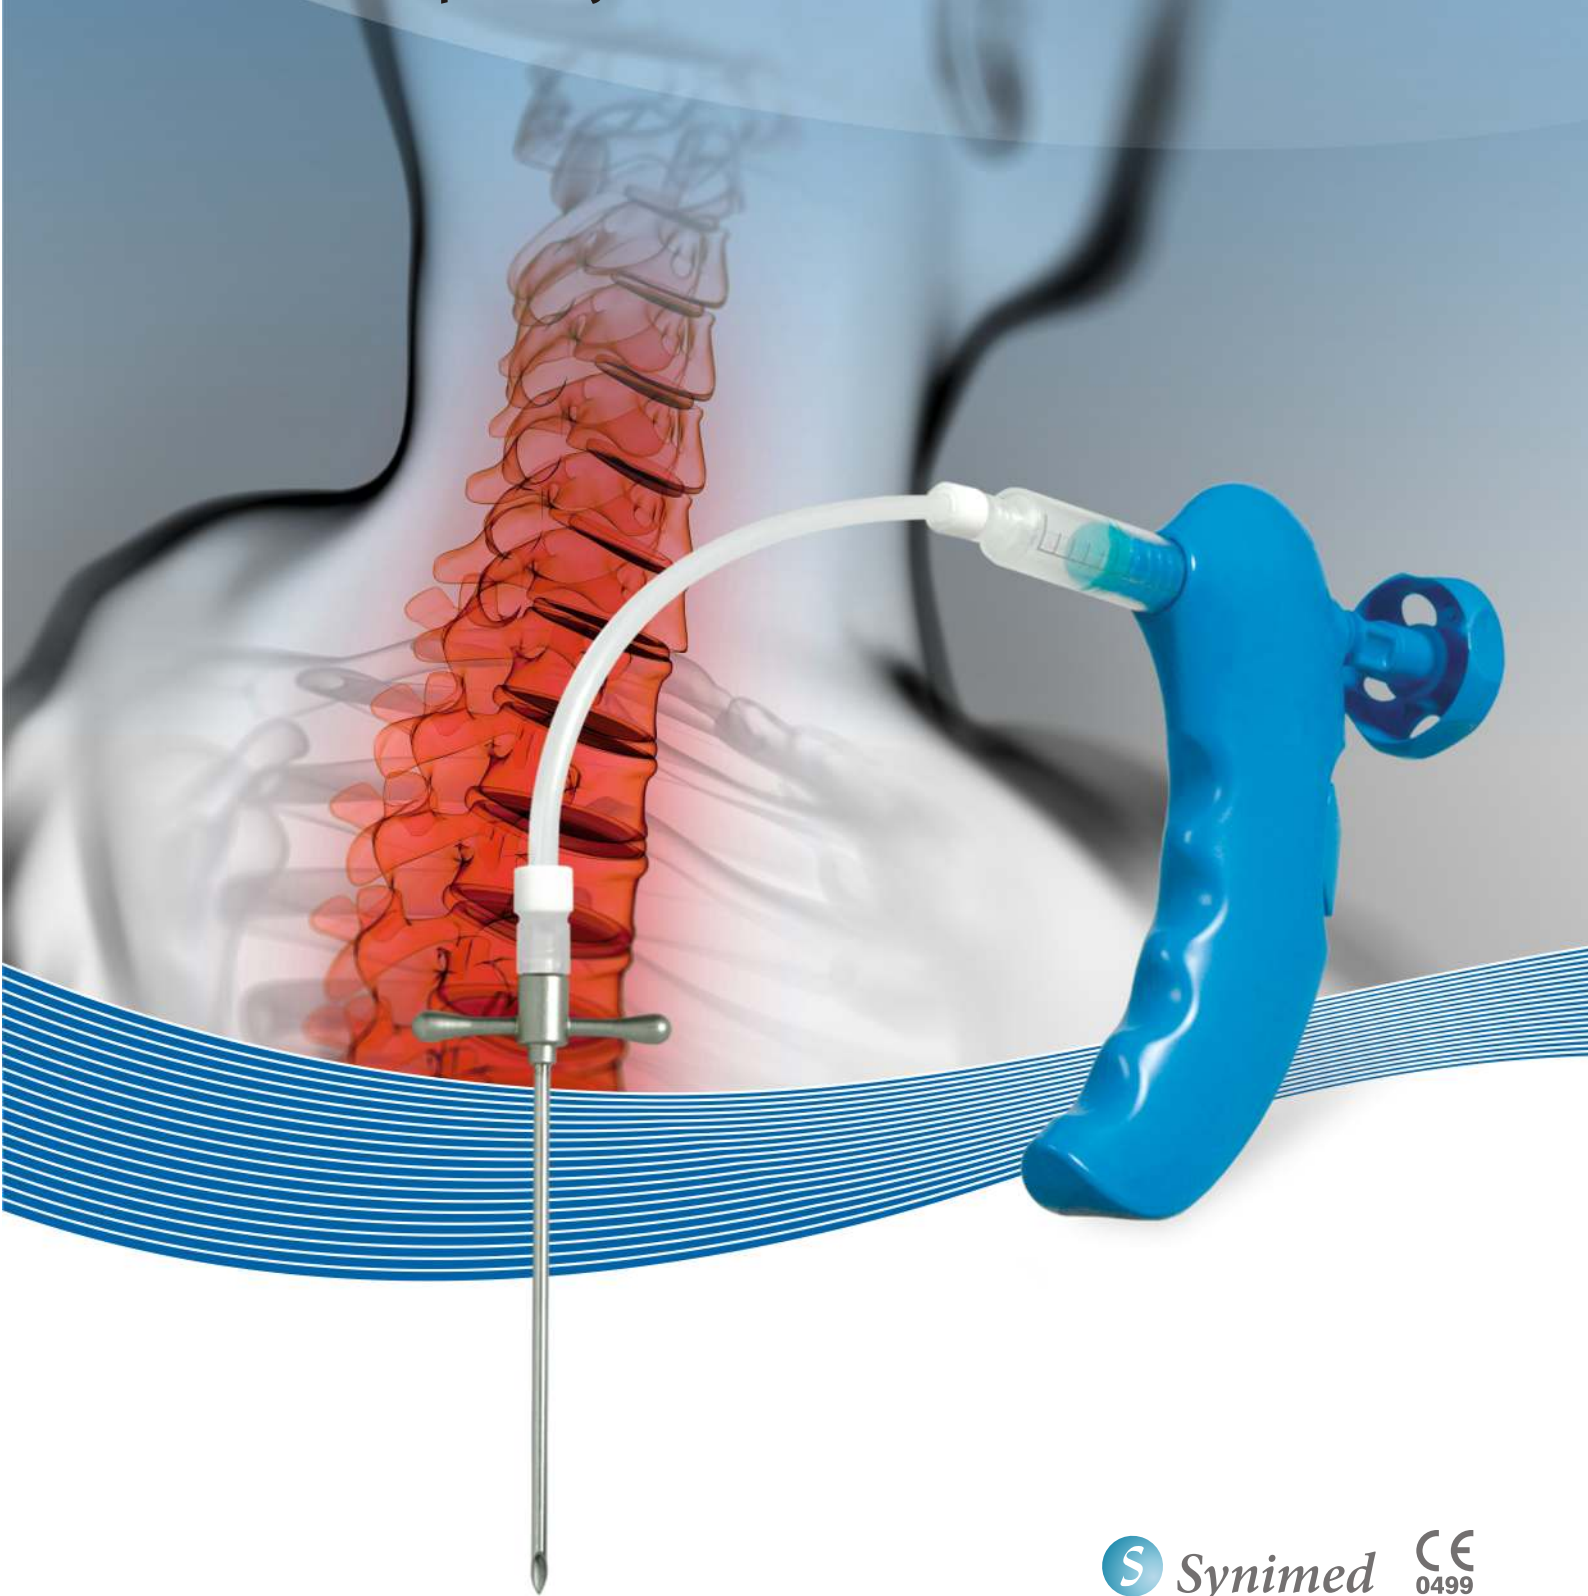

6 < 1, & (0 9 7 3

& (0 (1 7 2 3 \$ 5 \$ 9 (5 7 (% 5 2 3 / \$ 6 7 \$)

Ø [P B () 0 ;

(O F H P H Q W R D F U O L F D S D U D V H U X W L O L] D G R H Q 9 H U W H E U R S O D V W i D
H V S H F L D O P H Q W H S D U D V H U X W L O L] D G R H Q 9 H U W H E U R S O D V W i D
3 H U F X W i Q H D F R Q O R F X D O V H K D O R J U D G R X Q F R P S X H V W R T X H
F R P E L Q D W L H P S R V G H W U E D M R D G H F X D G R V F R Q X Q D P O W D
U D G L R S D F L G D G D O R V U D \ R V ;

& D O L G D G F H U W L I L F D G D

(O F H P H Q W R 6 \ Q L F H P 9 7 3 W L H Q H P D U F D M H / R (D Q W H U L R U W D P E L p Q D S O L F D E O H D
' L U H F W L Y D (X U R S H D & ((\ F X P S O H F R Q F O S H G G R X Q D U H V
, 6 2 \ F R Q O D H V S H F L I L F D F L Y Q , 6 2 V 6 H Q R E U D X Q D F R Q H [L y Q I L U P H S R U P H G L
F H P H Q W R V G H U H V L Q D D F U T O L F D S D U D L P S O D G W F O H U R V F D
v (O H V F H O H Q W H I L O R H Y L W D I U D F W X U D V L
H O S R V L F L R Q D P L H Q W R G H O D F i Q X O D
v % L V H O Q R W U D X P i W L F R
v \$ F H U R L Q R [L G D E O H G H J U D G R T X L U ~ U J L F

& D U D F W H U t V W L F D V \ 3 U R S L H G D G H V

v) i F L O 3 U H S D U D F L y Q \ D G P L Q L V W U D F L y Q
v % D M D Y L V F R V L G D G
v 6 L Q Q H F H V L G D G G H F R O R U D Q W H V U H W D U G D G R U H V R V R O Y H Q W H V
v 7 L H P S R V G H W U E D M R F R Q V W D Q W H V
v 5 H D F F L y Q H [R W p U P L F D F R Q W U R O D G
v 0 H M R U Y L V L E L O L G D G E D M R U D \ R V ;
v 0 H Q R U H [S R V L F L y Q G H S D F L H Q W H V \ R S H U V R O D O P a G L F R D
U D \ R V ;

& i Q X O D 6 \ Q L F H P 0 H W i O L F D

& È 1 8 / \$ ' (3 8 1 & , Ì 1 (6 7 e 5 , / 3 \$ 5 \$

9 (5 7 (% 5 2 3 / \$ 6 7 \$)

Ø [P B () 0 ;

Ø [P P 5 () 0 ;

Ø [P P 5 () 0 ;

v 6 H S X H G H Q D E R U G D U i i F L O P H Q W H Y p U W H
J U D F L D V D O D V G L P H Q V L R Q H V U H G X F L G D
G H O D V F i Q X O D V
/ R (D Q W H U L R U W D P E L p Q D S O L F D E O H D
F O S H G G R X Q D U H V
v 6 H Q R E U D X Q D F R Q H [L y Q I L U P H S R U P H G L
G H G W F O H U R V F D
v (O H V F H O H Q W H I L O R H Y L W D I U D F W X U D V L
H O S R V L F L R Q D P L H Q W R G H O D F i Q X O D
v % L V H O Q R W U D X P i W L F R
v \$ F H U R L Q R [L G D E O H G H J U D G R T X L U ~ U J L F

& i Q X O D 6 \ Q L F H P G H 3 0 i V W

& È 1 8 / \$ ' (3 8 1 & , Ì 1 (6 7 e 5 , / 3 \$ 5 \$

9 (5 7 (% 5 2 3 / \$ 6 7 \$)

Ø [P B () 0 ;

Ø [P P () 0 ;

Ø [P P 5 () 0 ;

v 0 D Q J R S O i V W L F R G H G L V H x R H U J R Q y P L F R
v / D V H V S H F L D O H V F D U D F W H U t V W L F D V G H O
D V H J X U D Q X Q D F R Q H [L y Q I L U P H Q W H F
v ([F H O H Q W H I L O R F R P E L Q D G R F R Q X Q E L V
v \$ F H U R L Q R [L G D E O H G H J U D G R T X L U ~ U J L F

& i Q X O D 6 \ Q L F H P ' 8 \$ /

& È 1 8 / \$ ' (3 8 1 & , Ì 1 (6 7 e 5 , / 3 \$ 5 \$

9 (5 7 (% 5 2 3 / \$ 6 7 \$) < % , 2 3 6 , \$

Ø [P P 5 () 0 ;

v 6 H S X H G H Q D E R U G D U i i F L O P H Q W H F L Y D W H
D O D V G L P H Q V L R Q H V U H G X F O D D V G H O R V
F i Q X O D V
v / R D Q W H U L R U W D P E L p Q H V E S G E F F O B U H
v 6 H O R J U D X Q D F R Q H [L y Q I L U P H S R U P H G L
G R E O H U R V F D
v (O H [F H O H Q W H I L O R H Y L W D I U D F W X U D V L
S R V L F L R Q D P L H Q W R G H O D F i Q X O D
v % L V H O Q R W U D X P i W L F R
v \$ F H U R L Q R [L G D E O H G H J U D G R T X L U ~ U J L F



6 < 1, & (0

6, 6 7 (0 \$ 9 (5 7 (% 5 2 3 / \$ 6 7 \$)

6 (7 ' (6 & \$ 5 7 \$ % / (3 \$ 5 \$ 6 (5 8 7 , / , = \$ ' 2

& 2 1 6 < 1, 0 (' 9 5 (8 7 , / , = \$ % / (

Ø [P B () 0 ;

Ø [P P 5 () 0 ;

Ø [P P 5 () 0 ;

& i Q X O D G H S X Q F L y Q G H O F X H U S R Y H U W H E U D O F R Q P D Q G U L O
P P [P P P P [P P \ P P
& R Q H F W R U / X H U / R F N P K
- H U L Q J D G H P O
e P E R O R G H O D M H U L Q J D
(V S i W X O D
5 H F L S L H Q W H S D U D P H I F O D U
0 D U W L O O R T X L U ~ U J L F R
& i Q X O D G H V X F F L y Q D V S L U D F L y Q

Synimed V3 GUN

DISPOSITIVO DE INYECCIÓN REUTILIZABLE
HECHO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE.

REF MX880579

Principales características

- De fácil operación.
- Diseño ergonómico.
- Esterilizable por autoclave, calor seco y ETO.
- Administración precisa del cemento tanto a presiones bajas como altas.
- Permite la inmediata interrupción de la administración de cemento.



SYNIMIX VTP

MEZCLADOR AL VACÍO PARA CEMENTOS
DE VERTEBROPLASTÍA.

REF MX880579

Synimix VTP está diseñado para mezclar una amplia gama de cementos.

- De fácil utilización.
- El cemento puede ser preparado con el mezclador directamente conectado a la jeringa de aplicación. Previene la exposición a vapores.
- Reduce la presencia de burbujas de aire atrapadas durante el mezclado.
- Evita la transferencia del cemento desde el mezclador a la jeringa ya que el cemento es directamente aspirado dentro de la Jeringa de Aplicación.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de Vertebroplastía.



APV SYNCICEM - SISTEMA VERTEBROPLASTÍA

SET DE VTP COMPLETAMENTE DESECHABLE


Ø 2.4 x 100 mm REF MX884030 - Ø 3.0 x 100 mm REF MX884032 - Ø 3.0 x 150 mm REF MX884033

Compuesto por:

1. Pistola inyectora de plástico con jeringa de 10ml.
2. Cánula de punción vertebral con mandril: 2.4 mm x 100 mm/3.0 mm x 100 mm y 150 mm.
3. Conector Luer Lock m/h.
4. Espátula.
5. Recipiente para mezclar.
6. Cánula de succión/aspiración.

Principales características:

- Esterilizado por ETO, listo para usar.
- De fácil utilización.
- Diseño ergonómico.
- Administración de cemento precisa tanto a bajas como altas presiones.
- Permite la inmediata interrupción de la administración de cemento.
- Aguja totalmente metálicas.

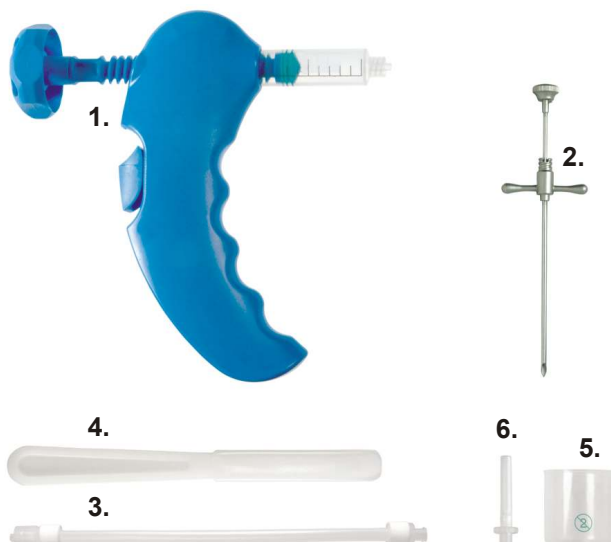

We deliver advanced solutions
in the field of medical devices.

www.synimed.com



Synergie Ingénierie Médicale S.A.R.L.
Zone Artisanale de l'Angle - 19370 Chamberet - FRANCE
Tél.: (+) 33 5 55 98 31 38 / Fax: (+) 33 5 55 98 35 76

970650/F1/01Y



Distribuidor: **MAXILARIA**

Avda. Siglo XXI, 16 - Local 2, 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Tlf: 91 633 53 90 | Fax: 91 633 59 08

www.maxilaria.com | pedidos@maxilaria.com